

EINKAMMERKISSEN

Diese einfache Anwendung führt Sie durch die notwendigen Schritte, um das Kissen mit der empfohlenen Luftmenge zu füllen. Das Kissen bietet so bereits eine gute Druckentlastung und sorgt für Komfort, zusätzlich empfehlen wir aber immer die umseitig beschriebene Handkontrolle durchzuführen.



1 Pumpen Sie das Kissen mit der Handpumpe auf, bis sich das Kissen leicht wölbt.



2 Entfernen Sie die Pumpe. Schließen Sie das Ventil nicht und lassen Sie die Luft entweichen.



3 Nach ca. 60 Sekunden hat sich der Innendruck des Kissens dem Umgebungsdruck angepasst.




4 Schließen Sie das Ventil.




5 Legen Sie das Kissen auf die Sitzfläche und setzen Sie sich auf das Kissen.

EINKAMMERKISSEN


Eine Handkontrolle sollte regelmäßig durchgeführt werden.

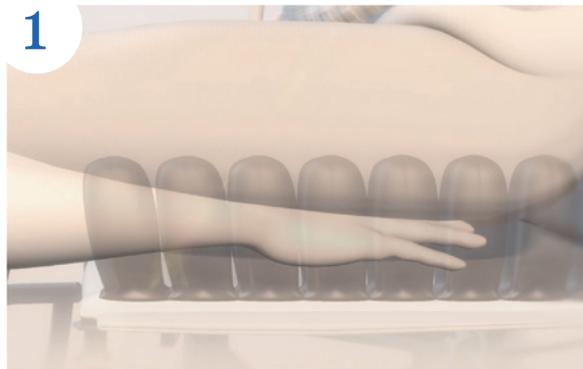


1 Schieben Sie eine Hand zwischen Kissen und Gesäß des Nutzers, bis Sie die Sitzbeinhöcker spüren.

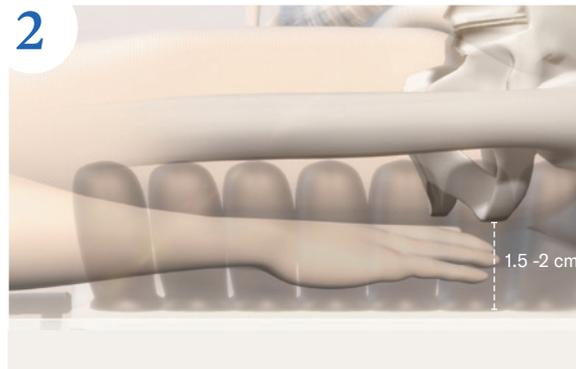

2 Prüfen Sie den Abstand der Sitzbeinhöcker zur Bodenplatte des Kissens durch Auf- und Abbewegung der Finger. Zwischen den Sitzbeinhöckern und der Bodenplatte des Kissens sollten 1,5 - 2 cm liegen.

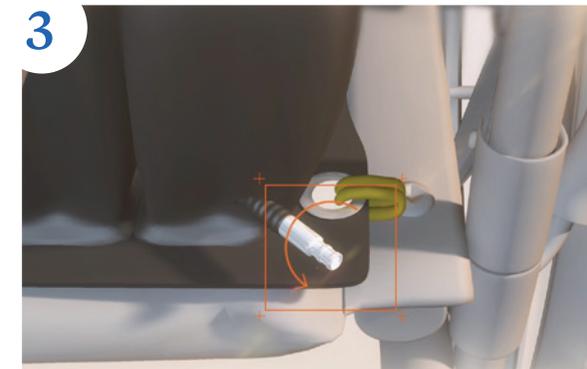

3 Lassen Sie bei zu großem Abstand (mehr als 2 cm) Luft entweichen oder geben Sie Luft mithilfe der mitgelieferten Pumpe hinzu, falls der Abstand zu gering ist, um ein optimales Einsinken und Umhüllen sicherzustellen.

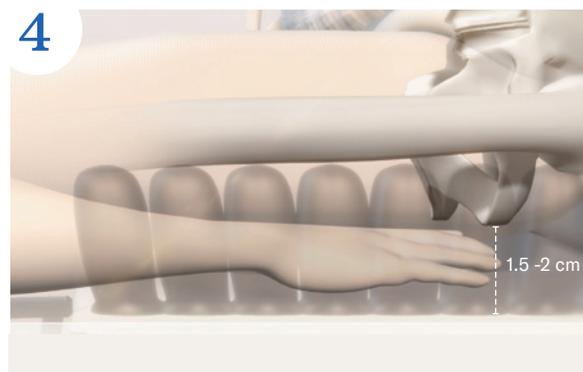

4 Erneute Prüfung des Abstandes zwischen Sitzbeinhöcker und Bodenplatte.



Diesen Abstand sollten Sie regelmäßig kontrollieren, um im Falle einer Beschädigung des Kissens Druckstellen zu vermeiden.